

# 包装変更のお知らせ



非イオン性尿路・血管造影剤

## イオパミロン<sup>®</sup>注 300 シリンジ 80mL/100mL

2025年 3月  
バイエル薬品株式会社

謹啓

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、弊社非イオン性尿路・血管造影剤「イオパミロン<sup>®</sup>注300シリンジ」の製造所の変更に  
伴い、包装を変更いたしますことをご連絡申し上げます。なお、この度の変更に伴う各種コードの  
変更はございません。

今後ともより一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

謹白

### 記

#### ■ 変更内容

- シリンジ形状、サイズ、ラベルデザインおよび材質(ガラスからプラスチック)
- 個装箱のサイズ、デザイン
- 元梱包のサイズ

#### ■ 対象製品の出荷開始時期

販売名	包装	統一商品 コード	GS1コード (販売包装単位)	GS1コード (調剤包装単位)	製造番号	出荷予定 時期*
イオパミロン <sup>®</sup> 注 300シリンジ	80mL×5	341104207	 (01)14987341104204	 (01)04987341304201	JP84015	2025年 4月下旬
	100mL×5	341104214	 (01)14987341104211	 (01)04987341304218	未定	2025年 7月中旬


※弊社物流センターにおける特約店様からの受注開始時期となります。

地域により、医療機関様への納入にはご発注から数日~1週間程度要する場合がございます。

\*変更品初回製造番号が「未定」の製品包装は、確定次第、弊社医療関係者向けサイト(<https://pharma-navi.bayer.jp/>)にてご連絡します。

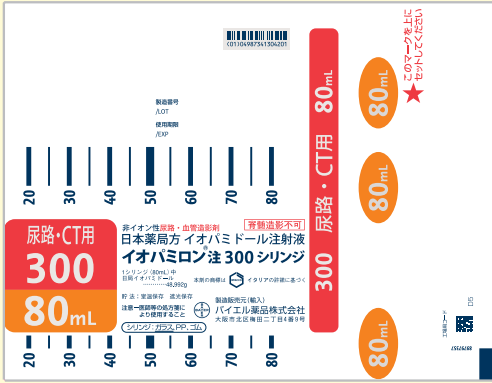

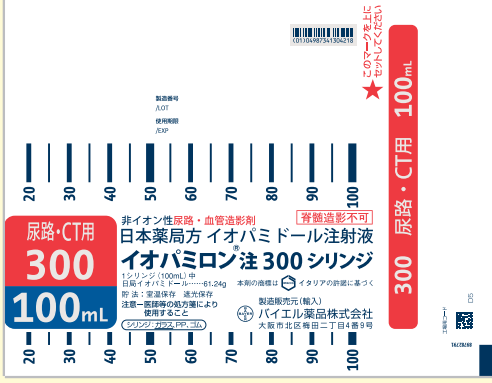
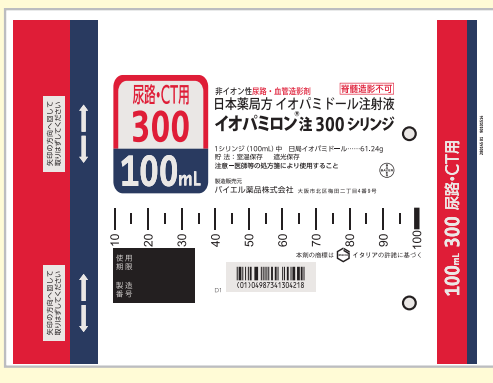
■ 変更箇所: シリンジ形状・サイズ

● イオパミロン® 注300シリンジ

変更前	80mL	
	100mL	
	サイズ、材質(2剤共通)	バレル長: 188.8mm(バレル本体) プランジャー直径: 35.5mm 材質: ガラス製
	開封方法(2剤共通)	スクリューキャップ開封後にチップキャップを取り外して使用。
変更後	80mL	
	100mL	
	サイズ、材質(2剤共通)	バレル長: 182.45mm(オーバーキャップ含む) プランジャー直径: 41.2mm 材質: プラスチック製
	開封方法(2剤共通)	バイエルの現行品(ガラスシリンジ製品)と比べてRFIDの貼付位置が90度変更になります。オーバーキャップを矢印方向に回転させ、オーバーキャップを取り外してご使用ください。インジェクタへのセット時の目印としてシリンジ本体に○印を2か所記載しております。

■ 変更箇所: シリンジラベル

● イオパミロン® 注300シリンジ

	変更前	変更後
80mL	 <p>旧ラベルデザイン: 縦長のシリンジラベル。中央に「尿路・CT用 300 80mL」とあり、下部に「イオパミロン注 300 シリンジ」の文字が小さく表示されている。背景は白と赤のストライプ。</p>	 <p>新ラベルデザイン: シリンジの筒に巻き付けられるように設計されたラベル。上部に「尿路・CT用 300 80mL」とあり、下部に「イオパミロン注 300 シリンジ」という大きな文字が配置されている。背景は白と赤のストライプ。</p>
100mL	 <p>旧ラベルデザイン: 縦長のシリンジラベル。中央に「尿路・CT用 300 100mL」とあり、下部に「イオパミロン注 300 シリンジ」の文字が小さく表示されている。背景は白と赤のストライプ。</p>	 <p>新ラベルデザイン: シリンジの筒に巻き付けられるように設計されたラベル。上部に「尿路・CT用 300 100mL」とあり、下部に「イオパミロン注 300 シリンジ」という大きな文字が配置されている。背景は白と赤のストライプ。</p>

■ 変更箇所: 個装箱のデザイン

● イオパミロン® 注300シリンジ

	変更前	変更後
80mL	 <p>旧個装箱デザイン: 白と赤の個装箱。正面には「イオパミロン注 300 シリンジ 80mL x 5」と表示されている。デザインは比較的古く、文字の配置がやや雑な印象がある。</p>	 <p>新個装箱デザイン: 白と赤の個装箱。正面には「イオパミロン注 300 シリンジ 80mL x 5」と表示されている。デザインは新しく、文字の配置が整っており、視認性が向上している。</p>
100mL	 <p>旧個装箱デザイン: 白と赤の個装箱。正面には「イオパミロン注 300 シリンジ 100mL x 5」と表示されている。デザインは比較的古く、文字の配置がやや雑な印象がある。</p>	 <p>新個装箱デザイン: 白と赤の個装箱。正面には「イオパミロン注 300 シリンジ 100mL x 5」と表示されている。デザインは新しく、文字の配置が整っており、視認性が向上している。</p>

## ■ 変更箇所:個装箱サイズ

販売名	包装	変更前 縦×横×高さ(mm)	変更後 縦×横×高さ(mm)
イオパミロン <sup>®</sup> 注 300シリンジ	80mL×5	253.5×234×96.5	240×202×86
	100mL×5	同上	同上

## ■ 変更箇所:元梱包サイズ

販売名	包装	個装箱数	変更前 縦×横×高さ(mm)	変更後 縦×横×高さ(mm)
イオパミロン <sup>®</sup> 注 300シリンジ	80mL×5	4	479×266×202	505×222×203
	100mL×5	4	同上	同上

※元梱包における個装箱の入数に変更はございません。

## ■ 本件に関するお問い合わせ

バイエル薬品株式会社 コンタクトセンター **0120-106-398**

自動音声ガイダンスにそって、「1.製品に関するお問い合わせ」を選択いただき、「イオパミロン注シリンジの包装変更について」とお伝えください。

フリーダイヤルがご利用いただけない場合:06-6133-7555

受付時間:9:00~17:30(土・日・祝日・弊社休日を除く)

以上